
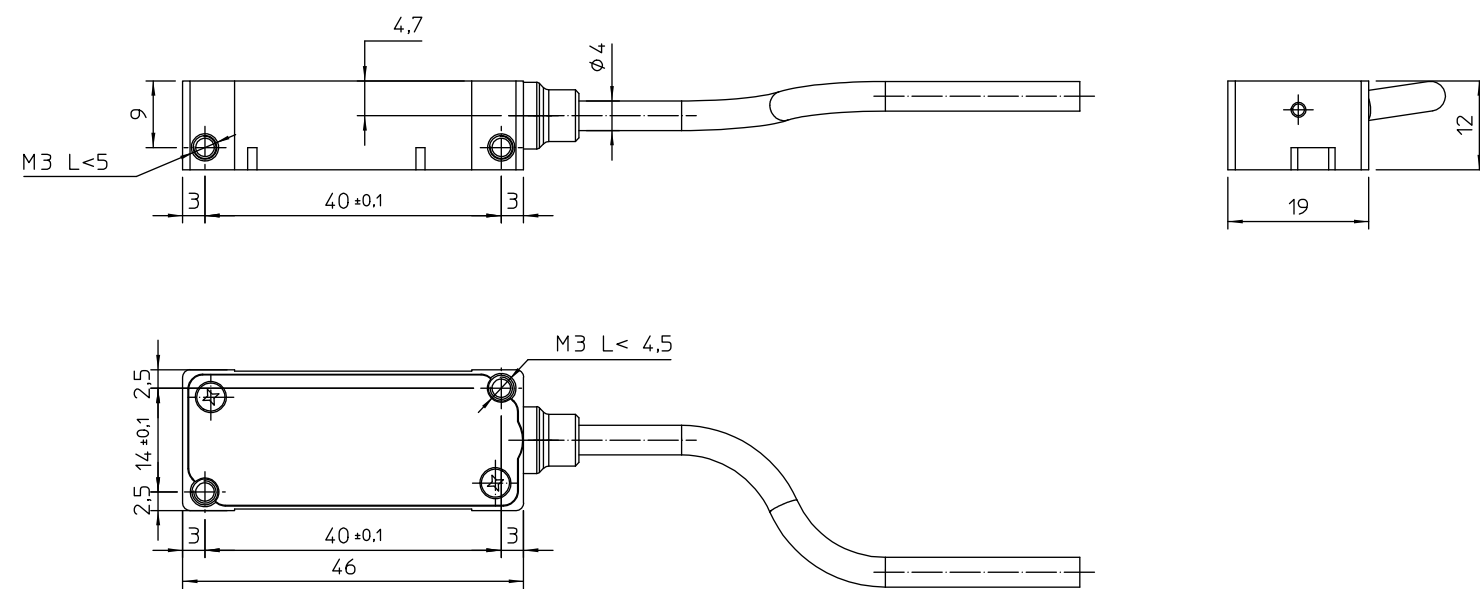



a2

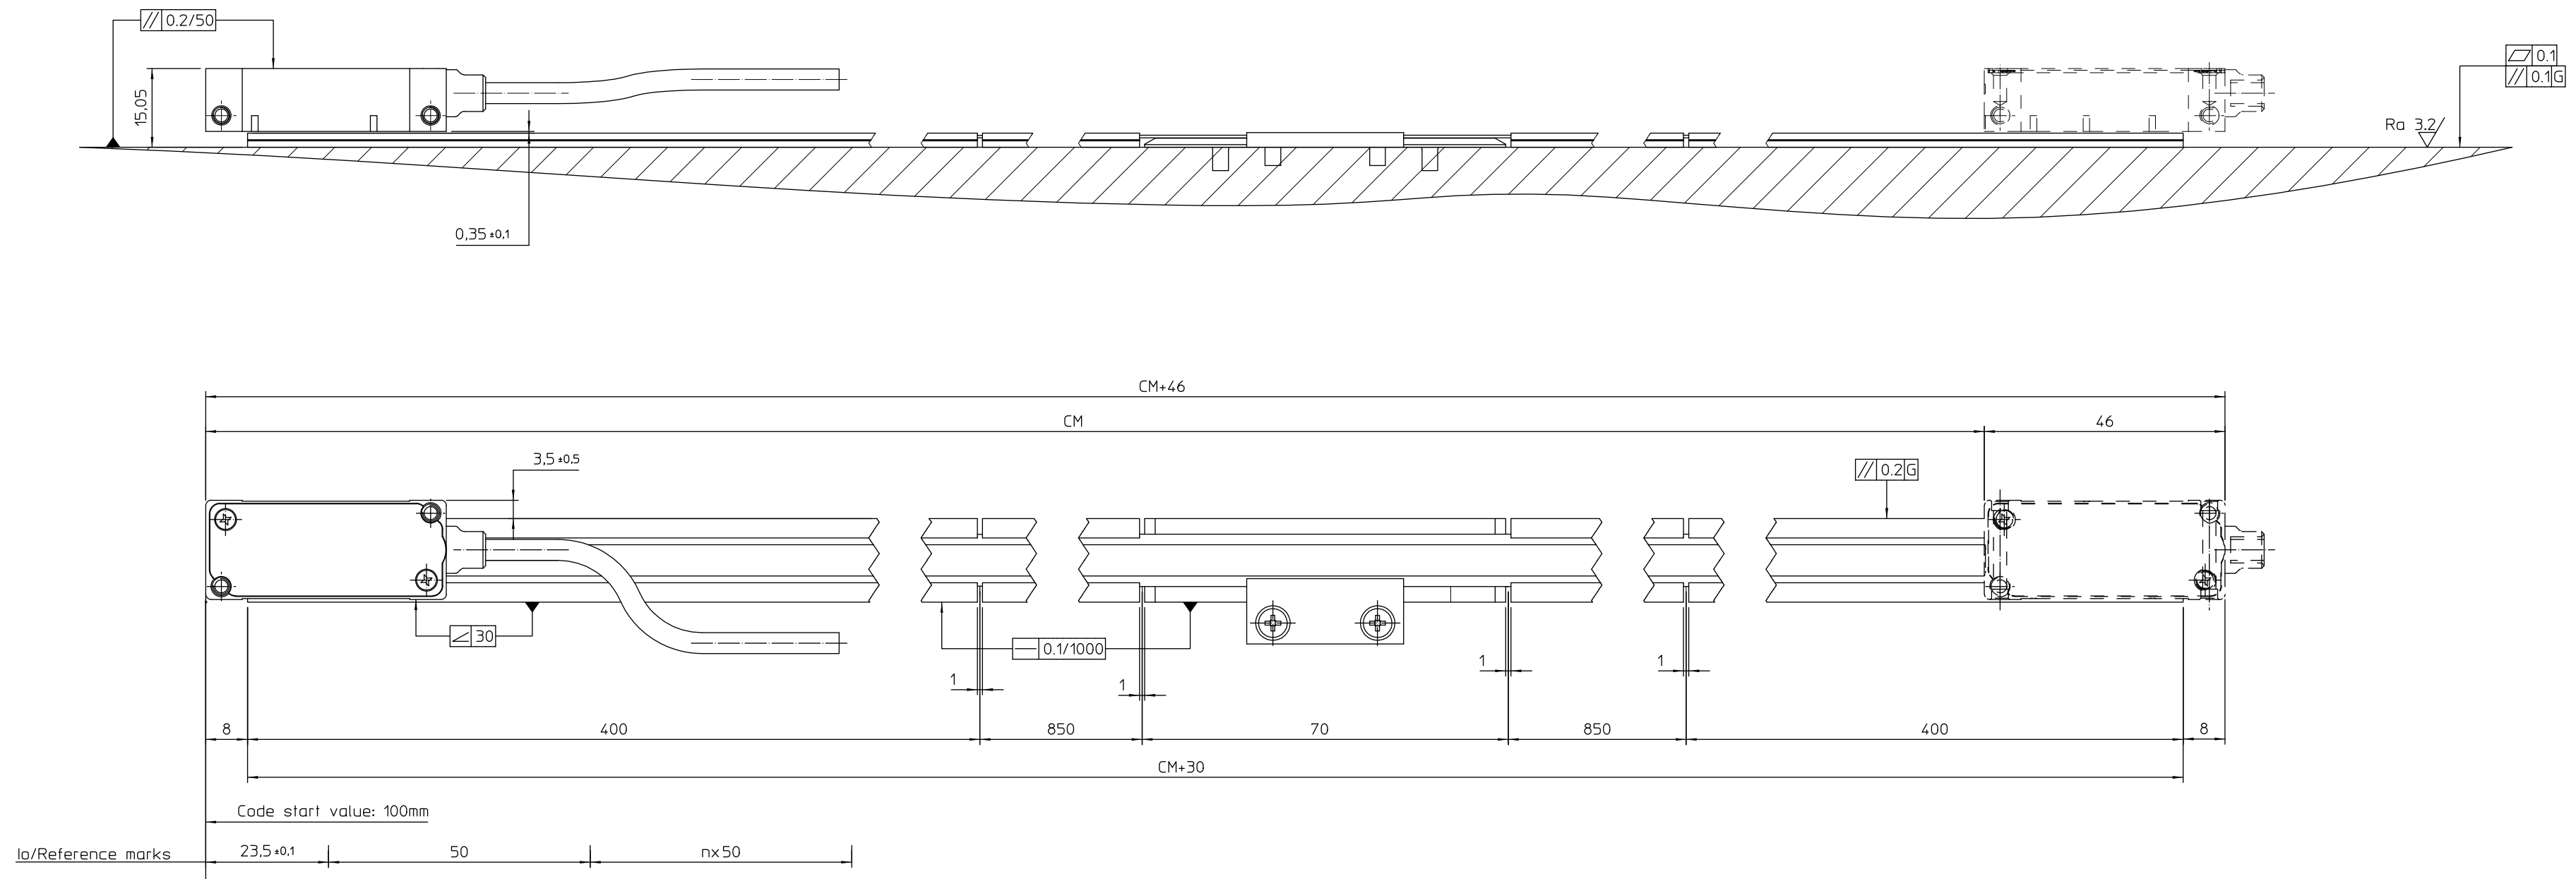

CM= 2540

CM = Curso medicina
CM = Measuring length
G = Guía máquina
G = Machine guideway

						Escala:
						Resto Tolerancias s/norma ISO 2768-mK
						< 5 ± 0,1 50 -100 ± 0,4
						5 - 25 ± 0,15 > 100 ± 0,6
						25 -50 ± 0,2 α° ± 30'
Nº	Modificado		Propu.	Vº Bº	Fecha	Entre ejes ± 0,25
Nº	Designación	EXG_EXGA-2540	Cant.	Material	Acabado	
P plano Nº	—	El 05-10-16	Fagor Automation	S. Coop.	20500 Mondragón	FAGOR 
Sustituye a:		Dibujado SORMEN				
		Comprobado				

